



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Шкапина ул., д. 30, лит. А,
Санкт-Петербург, 198095
Тел. (812) 576-22-22, факс (812) 576-22-23
E-mail: Mail@spbmiac.ru

Руководителям
учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга
(по списку)

04.06.26 № 1430

на № _____ от _____

Уважаемый Руководитель!

Во исполнение Распоряжения Комитета по здравоохранению от 28.04.2026 №198-р «Об утверждении порядка (регламента) применения медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений, полученных в ходе оказания медицинской помощи по лучевой диагностике лицам старше 18 лет» (далее – Распоряжение), в системе мониторинга медицинских учреждений «Сведение отчетности. Парус» (далее – Система мониторинга) реализован шаблон отчета об оказании медицинской помощи пациентам с применением медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта» (далее – Отчет «Применение ИИ при оказании МП_И11»).

Прошу Вас в срок **до 15 июня 2026 года**:

- 1) предоставить сведения о сотруднике Вашего учреждения, назначенного ответственным за формирование данного отчета в Системе мониторинга (Ф.И.О., должность, номер контактного мобильного телефона, электронный адрес) на электронный адрес cld@spbmiac.ru;
- 2) обеспечить внесение информации за май 2026 года в Систему мониторинга.

В дальнейшем Отчет «Применение ИИ при оказании МП_И11» необходимо предоставлять **ежемесячно**, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Расположение отчета в Системе мониторинга: Городской организационно-методический центр рентгенологии и радиологии/Отчет «Применение ИИ при оказании МП_И11».

Адрес Системы мониторинга в сети ЕМТС: <http://10.146.141.248/>

Телефон по вопросам заполнения отчета 573-97-65

Телефон по техническим вопросам 635-55-99.

Телефон для справок: 573-97-65.

Приложение:

1. Шаблон отчета «Применение ИИ при оказании МП_И11» в формате Excel.
2. Инструкция по заполнению отчета «Применение ИИ при оказании МП_И11» в Системе мониторинга.

Директор

П.С. Алексеев

Приложение № 3
к распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 28.04.2026 № 198-р

Отчет об оказании медицинской помощи пациентам с применением медицинских изделий с техно.логией искусственного интеллекта

Название в ИС ПАРУС: «Применение ИИ при оказании МП_ИИ1» (Рентген1).

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| ОИД МО в ФРМО | Наименование МО | Цифровой аппарат, на котором проводятся исследования РГ ОГК, ММГ, ФЛГ, КТ ОГК, КТ ГМ | | Серийный номер цифрового аппарата | Вид медицинского изделия в соответствии с ФРМО* (учитывается цифровое оборудование только с кодами вида: 135190, 282030, 113950, 209400, 191110, 208940, 173270, 113880, 191220, 173200, 209270, 114050, 191330)* | Подключение цифрового аппарата к ЦАМИ (не подключено; подключено напрямую; подключено через локальный PACS) | Количество проведенных исследований РГ ОГК на аппарате за отчетный период | из них передано в ЦАМИ за отчетный период | Комментарии МО |
| | | Наименование аппарата | Модель аппарата | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |
| | | | | X | X | | | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Количество проведенных исследований ММГ на аппарате за отчетный период | из них передано в ЦАМИ за отчетный период | Количество проведенных исследований ФЛГ на аппарате за отчетный период | из них передано в ЦАМИ за отчетный период | Количество проведенных исследований КТ ОГК на аппарате за отчетный период | из них передано в ЦАМИ за отчетный период | Количество проведенных исследований КТ ГМ на аппарате за отчетный период | из них передано в ЦАМИ за отчетный период | Комментарии МО | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | |

РГ ОГК - рентгенография органов грудной клетки
ФЛГ - флюорография
ММГ - маммография
КТ ОГК - компьютерная томография органов грудной клетки
КТ ГМ - компьютерная томография головного мозга


**Инструкция по заполнению отчета
«Применение ИИ при оказании МП_И11» в ИС Парус.**

1. Доступ к данному отчету осуществляется по учетной записи руководителя МО.
2. Так как для заполнения формы отчета используются загруженные в ИС Парус справочники оборудования, Вам необходимо:
 - 2.1. После входа в систему **создать отчет «Применение ИИ при оказании МП_И11»** (мпсмокод РентгенИИ).
 - Инструкция по работе в ИС Парус размещена на сайте СИБ ГБУЗ МИАЦ по ссылке <https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/parus/>
 - 2.2. **Выгрузить созданный отчет в Excel**, для чего навести курсор на строку отчета, нажать правую кнопку мыши и выбрать в выпадающем окне **Загрузка/Выгрузка**, далее выбрать **Выгрузить отчеты в Excel**. Выгруженный файл сохранить для дальнейшего использования в работе.

В выгруженном файле имеется три вкладки «Аппараты для РГ ОГК и ФЛП», «Аппараты для ММГ», «Аппараты КТ» с перечнем наименований оборудования, которые необходимы для заполнения графы 3 отчета в ИС Парус.
3. Далее необходимо в ИС Парус **открыть шаблон отчета для заполнения** – двойным щелчком мыши по строке отчета. В списке трафаретов выбрать **Шаблон_ИИ при оказании МП – для заполнения (Свод)** и приступить к внесению данных, для чего нужно добавить строку наведя курсор на заштрихованную строку, затем нажать правую кнопку мыши и выбрать **Таблица**, далее в выпадающем списке выбрать **Добавить строку**. Таким образом добавить необходимое количество строк.
4. **Графы 1 и 2** заполняются автоматически.
5. **В графу 3** вносятся только цифровые аппараты, на которых в отчетном периоде проводились исследования - рентгенография органов грудной клетки, флюорография, маммография, компьютерная томография органов грудной клетки, компьютерная томография головного мозга.
6. Наименование цифрового аппарата в графе 3 заполняется из выгруженных из ИС Парус таблиц путем копирования соответствующего вашему оборудованию наименования с использованием клавиш «Ctrl+C»(копировать) и «Ctrl+V»(вставить).
7. Если наименование цифрового аппарата отсутствует в выгруженных из ИС Парус таблицах, его необходимо внести в отчет вручную.

Обратите внимание!!! Вносимое наименование аппарата должно быть аналогично наименованию аппарата в Регистрационном удостоверении.
8. **В графе 4** указывается модель аппарата в соответствии с Регистрационным удостоверением и документацией на аппарат (вводится вручную).

9. В графе 5 указывается серийный (заводской) номер аппарата.
10. В графе 6 из справочника выбирается вид медицинского изделия с кодом в соответствии с ФРМО.
11. В графе 7 из выпадающего списка необходимо выбрать соответствующий вариант подключения к ЦАМИ.
12. Графы 8 – 17 заполняются вручную.
13. Количество проведенных исследований за отчетный период указывается за календарный месяц (с 1 по 31) без нарастающего итога.
14. Создание следующих отчетов возможно через функцию «Размножить» из выпадающего меню или путем нажатия на панели в верхнем правом углу на иконку с двойным листом.

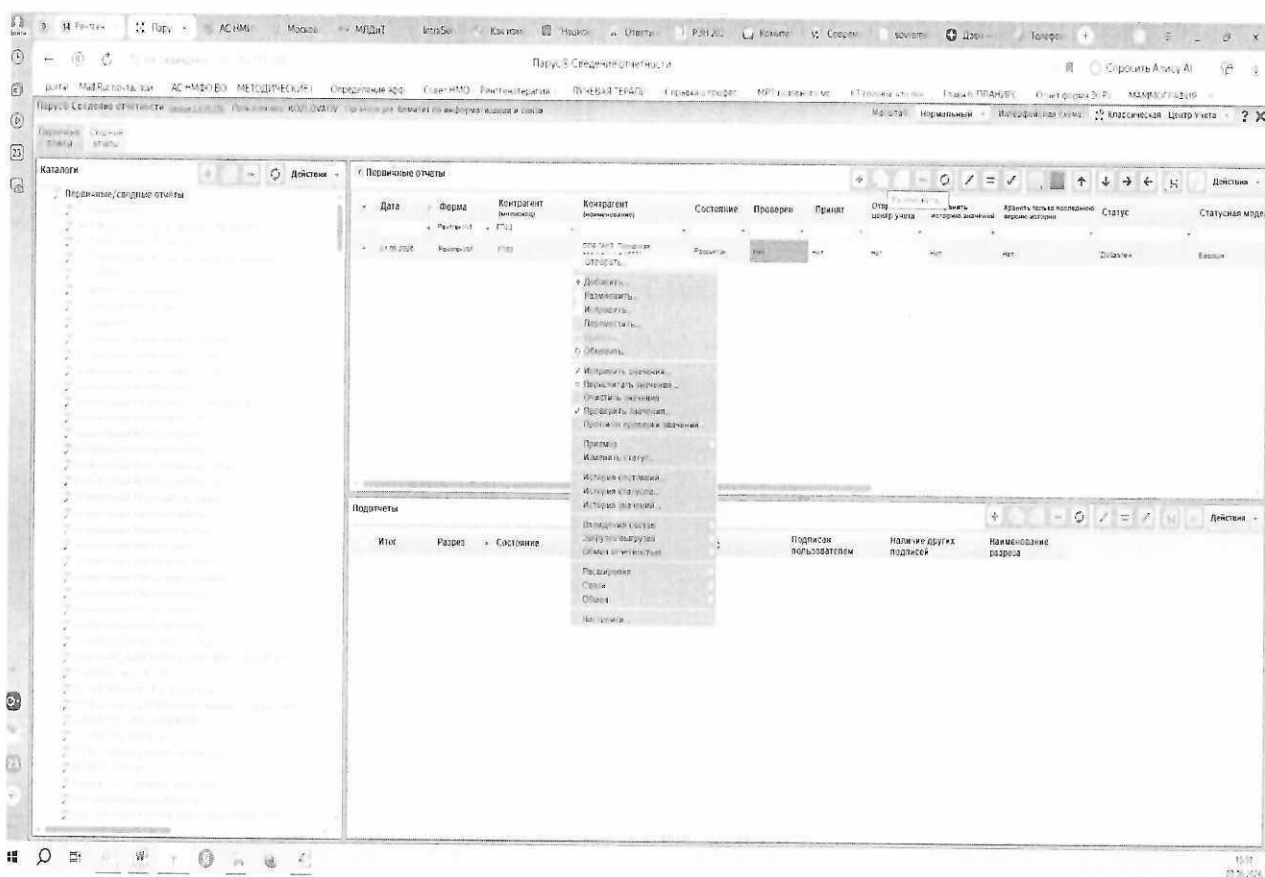

В открывшемся окне необходимо изменить дату на текущую и нажать ОК. Затем открыть отчет, проверить список аппаратов, при необходимости добавить новые аппараты или удалить те, на которых не проводились исследования за отчетный период, и откорректировать данные по гр. 7-17.

15. Завершив заполнение отчета его необходимо сохранить, закрыть и отправить в центр учета, нажав на панели в верхнем правом углу на иконку со стрелкой вправо →.